

EN Work positioning lanyard.  
IT Cordino di posizionamento sul lavoro.  
FR Longe de maintien au travail.  
DE Verbindungsmittel für Haltegurt.  
ES Componente de amarre para sujeción.  
PT Corda de posicionamento no trabalho.  
SE Stötdlinje för arbetspositionering.  
NO Støtteline for arbeidspositionering.  
FI Säädettävä tuki- ja varmistusteköysi.  
DA Line til arbeidspositionering.  
JP 作業位置決め用ひも。

REF. No. LENGTH  
7L91502\*\* 2 m  
7L91503\*\* 3 m  
7L91505\*\* 5 m

MADE IN ITALY  
EN 358:1999  
CE 0333



89/686/CEE -  
Personal Protective Equipment against falls from a height.



**CT**  
climbing  
technology

by Aludesign S.p.A. via Torchio 22  
I-24034 Cisano B. sco BG, ITALY  
Central tel: +39 035 78 35 95  
Central fax: +39 035 78 23 39  
www.climbingtechnology.com

## 1 MARKINGS

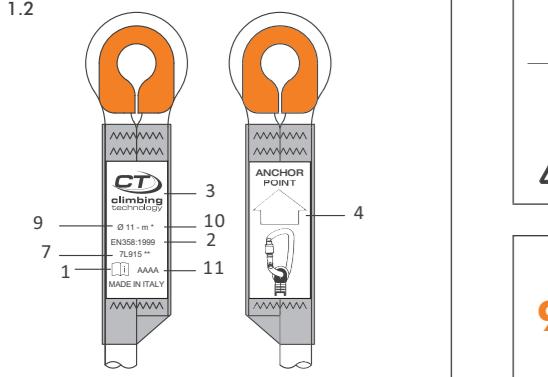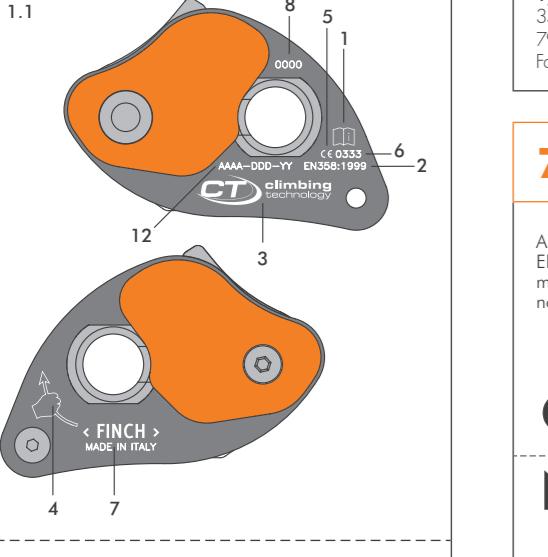


## 7 POSITION OF THE USER

Anchor point EN 813 - min. 12 kN or 18 kN for non-metallic anchors


OK  
NO!

## 8 INSPECTION POINTS



EN 795 - Qualsiasi attività svolta oltre i due metri di altezza presuppone l'impiego di Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro il rischio di cadute. Prima di accedere alla postazione di lavoro si devono considerare tutti i fattori di rischio (ambientali, concomitanti, conseguenziali). Questa frequenza può essere variata in funzione della frequenza e dell'intensità di utilizzo. L'esecuzione dei controlli periodici regolari è indispensabile per garantire la continua efficienza e durata del dispositivo, da cui dipende la sicurezza dell'utilizzatore. I risultati dei controlli saranno riportati sull'apposita scheda che correda e deve accompagnare ogni dispositivo. **Attenzione! Il mancato della scheda, o se illeggibile, estenderà l'utilizzo.** **Scheda di identificazione del dispositivo (Fig. A):** A) Marchio commerciale; B) Produttore; C) Prodotto (tipo, modello, codice); D) Utente (società, nome e indirizzo); E) Numero di serie / lotto; F) Anno di produzione; G) Data di primo uso; H) Data di prima utilizzazione; I) Data d'esp. / data di riacquisto; J) Norme di riferimento; M) Ente notificato che ha effettuato l'esame; N) Ente notificato che controlla la produzione. **Scheda di controllo periodico del dispositivo (Fig. B):** O) Data; P) Motivo del controllo: controllo periodico o controllo eccezionale; Q) Nome e firma del responsabile del controllo; R) Annotazioni (difetti rilevati, riparazioni effettuate o altre informazioni pertinenti); S) Esito del controllo: dispositivo idoneo all'uso, dispositivo non idoneo all'uso o dispositivo da verificare; T) Data del controllo successivo.

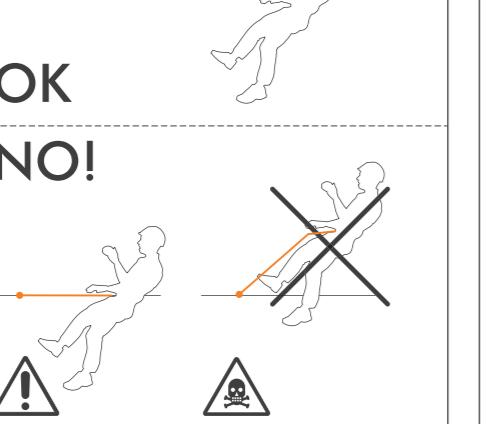


9

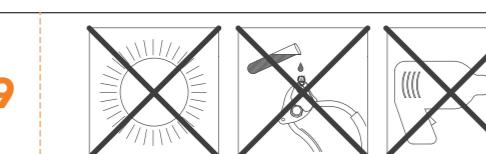


## 2 NOMENCLATURE OF PARTS

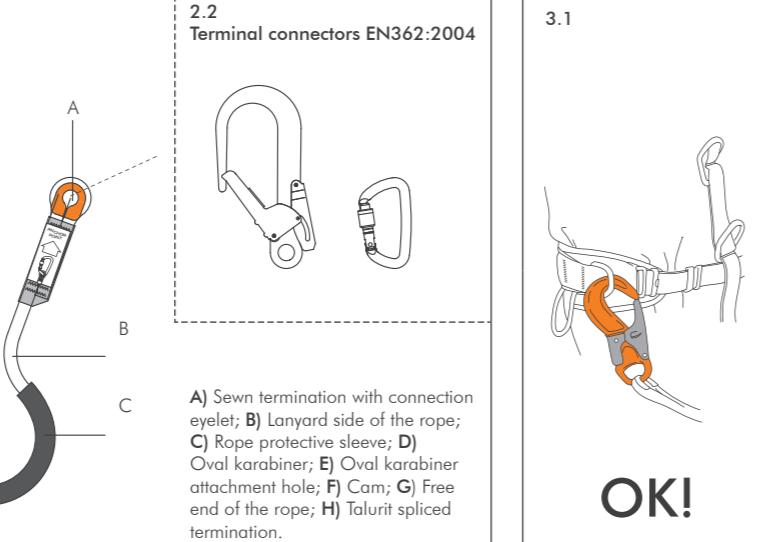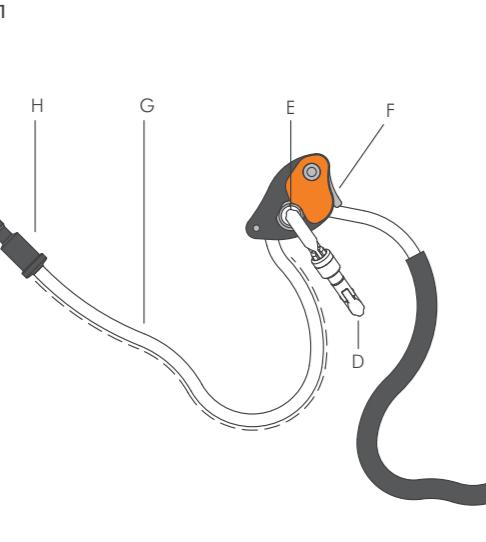

## 3 POSITIONING THE CONNECTOR

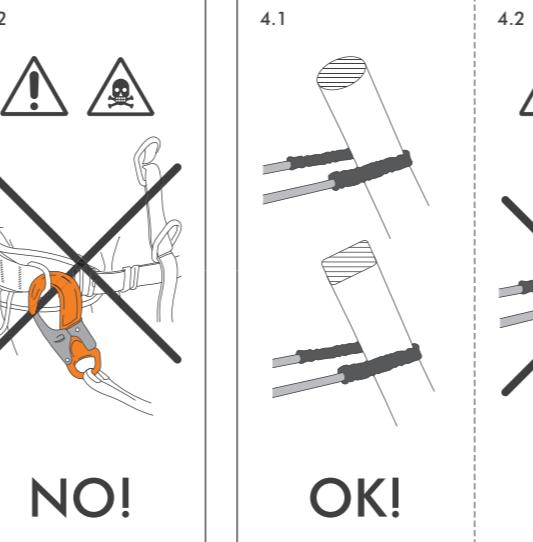

## 4 WARNING! BEWARE OF SHARP EDGES.

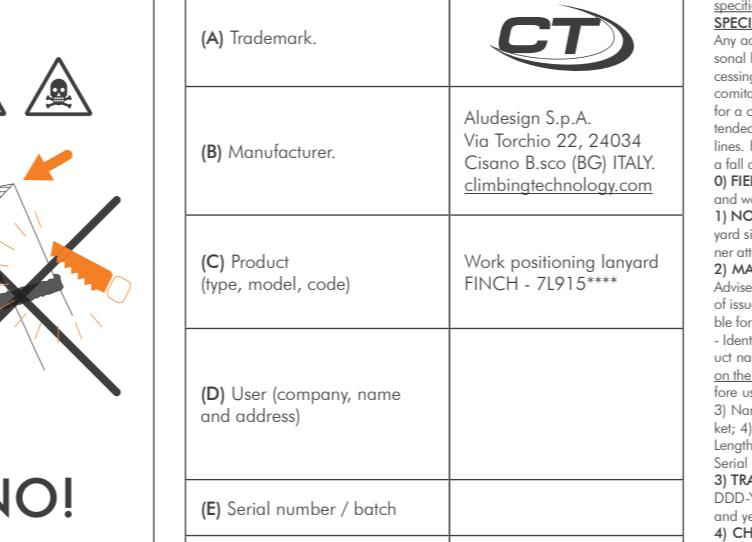

## A DEVICE IDENTIFICATION SHEET.

(A) Trademark.	
(B) Manufacturer.	Aludesign S.p.A. Via Torchio 22, 24034 Cisano B. sco (BG) ITALY. climbingtechnology.com
(C) Product (type, model, code)	Work positioning lanyard FINCH - 7L915****
(D) User (company, name and address)	
(E) Serial number / batch	
(F) Year of manufacture	
(G) Purchase date.	
(H) Date of first use.	
(I) Expiry date.	
(L) Reference standards.	□ EN 358:1999
(M) Notified Body that performed CE check:	
(N) Notified Body that controls production:	
(O) Data	NOTIFIED BODY "0082" CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE

No.	(O) Date.	(P) Reason for check.	(Q) Name and signature of the person responsible for checking.	(R) Notes (defects found, repairs performed or other relevant information)	(S) Check results.	(T) Date of next check.
1		<input type="checkbox"/> Periodic check. <input type="checkbox"/> Additional check.			<input type="checkbox"/> Device suitable for use. <input type="checkbox"/> Device not suitable for use. <input type="checkbox"/> Device to be checked.	
2		<input type="checkbox"/> Periodic check. <input type="checkbox"/> Additional check.			<input type="checkbox"/> Device suitable for use. <input type="checkbox"/> Device not suitable for use. <input type="checkbox"/> Device to be checked.	
3		<input type="checkbox"/> Periodic check. <input type="checkbox"/> Additional check.			<input type="checkbox"/> Device suitable for use. <input type="checkbox"/> Device not suitable for use. <input type="checkbox"/> Device to be checked.	
4		<input type="checkbox"/> Periodic check. <input type="checkbox"/> Additional check.			<input type="checkbox"/> Device suitable for use. <input type="checkbox"/> Device not suitable for use. <input type="checkbox"/> Device to be checked.	
5		<input type="checkbox"/> Periodic check. <input type="checkbox"/> Additional check.			<input type="checkbox"/> Device suitable for use. <input type="checkbox"/> Device not suitable for use. <input type="checkbox"/> Device to be checked.	
6		<input type="checkbox"/> Periodic check. <input type="checkbox"/> Additional check.			<input type="checkbox"/> Device suitable for use. <input type="checkbox"/> Device not suitable for use. <input type="checkbox"/> Device to be checked.	
7		<input type="checkbox"/> Periodic check. <input type="checkbox"/> Additional check.			<input type="checkbox"/> Device suitable for use. <input type="checkbox"/> Device not suitable for use. <input type="checkbox"/> Device to be checked.	
8		<input type="checkbox"/> Periodic check. <input type="checkbox"/> Additional check.			<input type="checkbox"/> Device suitable for use. <input type="checkbox"/> Device not suitable for use. <input type="checkbox"/> Device to be checked.	
9		<input type="checkbox"/> Periodic check. <input type="checkbox"/> Additional check.			<input type="checkbox"/> Device suitable for use. <input type="checkbox"/> Device not suitable for use. <input type="checkbox"/> Device to be checked.	
10		<input type="checkbox"/> Periodic check. <input type="checkbox"/> Additional check.			<input type="checkbox"/> Device suitable for use. <input type="checkbox"/> Device not suitable for use. <input type="checkbox"/> Device to be checked.	

individual serial number AAAA - DDD - YY
progressive number
day of manufacture
year of manufacture

C TRACEABILITY
----------------

1) DOMAIN D'APPLICATION: EN 358:1999 - Ceintures de maintien au travail et longes de maintien.
1) NOMENCLATURE (Fig. 2.1): A) Osse pour connecteur terminal; B) Lato cordo; C) Guaine di protezione; D) Connettore ovale; E) Freno per rotellina ovale; F) Cam; G) Freno di fondo; H) Talurit cordo libero; I) Telaio per attacco laterale.
2) MARKERUNG: Das Gerät ist mit folgenden Daten markiert (Abb. 1.1): 1) Logo, das den Kunden darauf hinweist, dass die Anweisungen aufgerufen werden müssen; 2) Nummer und Jahr der EN-Beschriftung; 3) Name des Herstellers oder des verantwortlichen Vermarkters; 4) Korrekte Benutzungsrichtung des Reglers; 5) FG-Markierung; 6) 0333 - Nummer des Organismus, der den Kontrollabstempel bestellt; 7) Modell des Produktes; 8) Partnummer (0000). Auf dem Seilabstempel (Abb. 1.2) befinden sich folgende Daten: 1) das Logo, das den Kunden darauf hinweist, dass die Anweisungen aufgerufen werden müssen; 2) Nummer und Jahr der EN-Beschriftung; 3) Name des Herstellers oder des verantwortlichen Vermarkters; 4) Korrekte Benutzungsrichtung des Reglers; 5) FG-Markierung; 6) Seriennummer (AAA-000-DDD-YY).
3) SPECIFIC INSTRUCTIONS EN 358: 1) Any activity carried out at a height of more than two metres requires the use of Personal Protection Equipment (PPE) as a protection against the risk of a fall. Before accessing the work station, all the risk factors must be evaluated (environmental, constant, consequent). These user instruction include the necessary information for a correct use of the adjustable lanyard for work positioning Finch. This PPE is intended to be included in a fall protection system as, for example, harnesses and life lines. Full body harnesses are the only mean of retaining for the body permitted in a fall arrest system.
4) CONTROLS: Avant chaque utilisation vérifier que: il n'y ait pas de signes d'usure, corrosion ou déformation; la came de blocage tourne librement sans se coincer; le connecteur dans le trou de l'équipement puisse tourner sans obstacles externes; le système de fermeture des connecteurs fonctionne correctement; il n'y ait pas de solissure ou poussière (par exemple sale); la corde et les coutures ne présentent pas de coupe, de point d'ouverture, d'abrasions, de brûlures ou de corrosions. Avant de commencer un travail sur corde : il faut prévoir une procédure de secours pour la récupération de l'opérateur en difficulté; il faut informer l'utilisateur de cette procédure de secours préalable. Pendant chaque utilisation : vérifier régulièrement le bon fonctionnement du produit, les points de liaison et la disposition des autres composants du système; s'assurer qu'il n'y ait pas de corps étrangers qui puissent interférer avec le bon fonctionnement de l'équipement; vérifier régulièrement le système de fermeture du connecteur avant et après chaque emploi.
5) NOTICES POUR L'EMPLOI: Le dispositif doit être étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
6) AVERTISSEMENT: Le longe réglable de maintien au travail avec régulateur FINCH n'est pas apte à arrêter les chutes. Lorsqu'il existe un risque de chute, il faut l'intégrer avec un dispositif antichute individuel, ou, en alternatif utiliser un système de protection collective. Dans un système d'arrêt des chutes, il est essentiel, pour des raisons de sécurité, de vérifier l'espace libre requis sous l'opérateur pour la récupération de l'opérateur en difficulté; il faut informer l'utilisateur sur le travail de maintien au travail avec chaque utilisation possible, de manière à ce que, en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol; la présence d'objets ou de personnes dans la trajectoire de la chute. Dans l'ordre de régulation: 1) Utiliser le connecteur ovale fourni, conforme à la norme EN362:2004. L'utilisation d'un connecteur autre que celui fourni compromet le bon fonctionnement du dispositif. 2) Utiliser une came de blocage tourne librement sans se coincer; le connecteur dans le trou de l'équipement puisse tourner sans obstacles externes; le système de fermeture des connecteurs fonctionne correctement; il n'y ait pas de solissure ou poussière (par exemple sale); la corde et les coutures ne présentent pas de coupe, de point d'ouverture, d'abrasions, de brûlures ou de corrosions. 3) Utilisation: Avant chaque utilisation vérifier que: il n'y ait pas de signes d'usure, corrosion ou déformation; la came de blocage tourne librement sans se coincer; le connecteur dans le trou de l'équipement puisse tourner sans obstacles externes; le système de fermeture des connecteurs fonctionne correctement; il n'y ait pas de solissure ou poussière (par exemple sale); la corde et les coutures ne présentent pas de coupe, de point d'ouverture, d'abrasions, de brûlures ou de corrosions. 4) Utilisation: Avant chaque utilisation vérifier que: il n'y ait pas de signes d'usure, corrosion ou déformation; la came de blocage tourne librement sans se coincer; le connecteur dans le trou de l'équipement puisse tourner sans obstacles externes; le système de fermeture des connecteurs fonctionne correctement; il n'y ait pas de solissure ou poussière (par exemple sale); la corde et les coutures ne présentent pas de coupe, de point d'ouverture, d'abrasions, de brûlures ou de corrosions. 5) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
6) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
7) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
8) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
9) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
10) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
11) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
12) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
13) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
14) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
15) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
16) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
17) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
18) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
19) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques; il ne cause pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.
20) INSTRUCTIONS POUR USE: Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température de utilisation comprise entre -30°C et +

